



Alcoholímetro con cámara
integrada

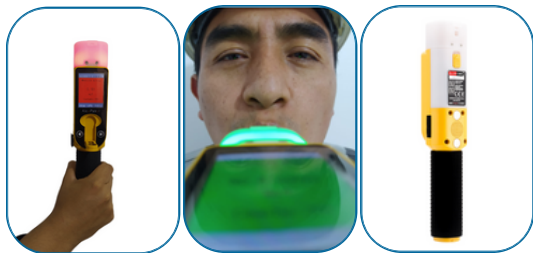

SMART CHECK[®]

ALCO CAM

Alcoholímetro Alcocam

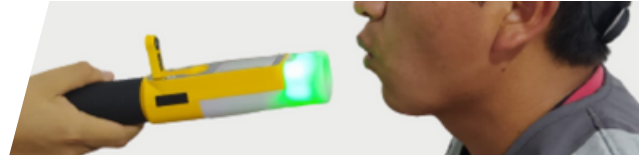

ACERCA DE ALCOCAM

El Alcoholímetro Alcocam es un equipo con cámara integrada para la detección de alcohol en la sangre. Ofrece Modo Activo, Pasivo y Screening. Por su diseño, modo de empleo y facilidad de uso, el Alcocam es el equipo ideal para realizar grandes cantidades de pruebas y así prevenir y buscar disminuir los riesgos de accidentes.

CARACTERÍSTICAS

Pruebas con boquillas o con cono de muestreo

Permite realizar las pruebas activas con el uso de boquillas descartables o con cono de muestreo.



Resultados cualitativos y cuantitativos

Cuantitativa: valor de alcohol en diferentes medidas como %BAC, g/L, mg/L

Cualitativa: **Alcohol** o **No hay Alcohol.**

El único alcoholímetro con cámara incorporada

El primer alcoholímetro que permite capturar la foto del evaluado en el momento de la prueba para una mejor evidencia.



12 pruebas por minuto

Posee una avanzada celda de combustión de alta precisión asegurando una larga vida útil del equipo, así como la rápida detección de alcohol en el aliento de las personas. Permitiendo realizar hasta 12 pruebas por minuto, es portátil y de fácil uso.

Alcoholímetro Alcocam



CARACTERÍSTICAS

Memoria interna de pruebas

El dispositivo guarda hasta **50.000** pruebas de alcoholemia de manera automática.

Counter	Num	Measure Mode	Alcohol Content	Measure Date	Measure Time	Lat	Test Person	Latitude
76	76	Active Test	0.000 %BAC	2022-03-31	09:24:17	0	0	0
77	77	Active Test	0.000 %BAC	2022-03-31	09:25:23	0	0	0
78	78	Active Test	0.000 %BAC	2022-03-31	09:26:44	0	0	0
79	79	Active Test	0.000 %BAC	2022-03-31	09:28:17	0	0	0
80	80	Passive Test	0.000 %BAC	2022-03-31	09:51:16	0	0	0
81	81	Passive Test	0.000 %BAC	2022-03-31	09:59:18	0	0	0
82	82	Passive Test	0.000 %BAC	2022-03-31	10:06:26	0	0	0
83	83	Passive Test	0.107 %BAC	2022-03-31	10:06:29	0	0	0
84	84	Passive Test	0.000 %BAC	2022-03-31	10:13:16	0	0	0
85	85	Passive Test	0.000 %BAC	2022-03-31	10:13:49	0	0	0
86	86	Passive Test	0.141 %BAC	2022-03-31	10:14:09	0	0	0
87	87	Passive Test	0.000 %BAC	2022-03-31	10:14:52	0	0	0
88	88	Passive Test	0.000 %BAC	2022-03-31	10:15:10	0	0	0
89	89	Passive Test	0.000 %BAC	2022-03-31	10:15:27	0	0	0
90	90	Passive Test	0.000 %BAC	2022-03-31	10:16:20	0	0	0
91	91	Passive Test	0.026 %BAC	2022-03-31	10:16:36	0	0	0
92	92	Active Test	0.017 %BAC	2022-03-31	10:18:26	0	0	0

Imprime los resultados

Permite agregarle una impresora portátil con conexión vía Bluetooth. Sin importar donde se encuentre, permite imprimir los resultados de las pruebas de alcoholemia.



Conexión con la computadora

El alcoholímetro puede conectarse a la computadora vía USB para la extracción de datos de pruebas tomadas con el equipo. También se puede exportar los datos a un archivo PDF para su posterior procesamiento. Previamente debe instalar el software incluido con el equipo ALCOCAM.

Registra los datos del evaluado

Puede colocarse datos pertinentes de la prueba, como: dirección, nombre del evaluado, nombre del operador y firma. Se pueden imprimir todos los vouchers que sean necesarios.

AP 035
Alcohol Tester
Contador: 52
Fecha: 30-03-2022
Hora: 23:00:21
A modo de prueba:
Modo activa BAC
Los datos de prueba:
0.000 %BAC

Estación: -----
Dirección: -----
Lugar de prueba: -----
Nombre de compr: -----

persona comprobada: -----
Firma: -----
Observaciones: -----

Alcoholímetro Alcocam



MODO DE EMPLEO

Modo Prueba Activo

Alcoholímetro profesional de alta fiabilidad permite realizar pruebas activas (soplar directamente en el cono y/o boquilla).



Modo Prueba Pasivo

Pruebas pasivas: absorbe el aliento del evaluado en caso que no desee soplar.



Modo Prueba Screening

El modo Screening permite evaluar la presencia de alcohol en bebidas o en el ambiente.



Alcoholímetro Alcocam



DESCRIPCIÓN DEL ALCOCAM

USO DE BOQUILLAS DESCARTABLES
PARA BIO - SEGURIDAD

RECORDATORIO DE CALIBRACIÓN
1 VEZ AL AÑO

PANTALLA TFT QUE CAMBIA DE
COLOR SEGÚN EL RESULTADO

Verde o Rojo

IDIOMA ESPAÑOL

CÁMARA INTEGRADA

CON BOTONES PARA LUCES
INTERMITENTES Y ALARMA
SONORA POLICIAL

CONOS DE MUESTREOS DESMONTABLES
Y BOQUILLAS DESCARTABLES PARA
BIO - SEGURIDAD


BOTÓN DE FÁCIL DESMONTAJE
DE CONOS DE MUESTREO

PUERTO USB PARA
CONEXIÓN A PC

IMANES PARA ADHERIRSE A
SUPERFICIES METÁLICAS

BATERÍA RECARGABLE

MANGO ERGONÓMICO PARA
FÁCIL MANIPULACIÓN

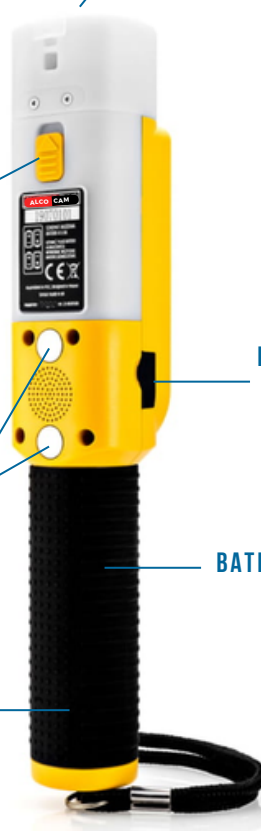

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sensor	Celda de combustión específico para alcohol
Rango de medición (BrAC)	0.000 mg/L - 4.500 mg/L
Pantalla	TFT de 2.4"
Botones	3 botones de operación
Alimentación	Batería recargable de Litio Ion de 3.7 V
Autonomía	05 horas de uso continuo
Visualización de resultados	En pantalla: Verde (negativo) y Rojo (Positivo)
Monitoreo de flujo	Detecta el flujo automáticamente
Modos de pruebas	3 modos: Activo, Pasivo y Screening
Tiempo de respuesta	2 segundos
Tiempo de reinicio	Para pruebas positivas 10 segundos, negativas 2 segundos.
Temperatura de operación	-5°C A 50°C
Resultados	Cuantitativos o Cualitativos
Consumibles	Se puede realizar pruebas con boquillas o sin boquillas
Niveles de alerta	Visual (En pantalla y luces en la parte superior) y Sonoro (Parlante)
Descarga de datos	Mediante cable USB con conexión a PC
Memoria	Almacena 50,000 mediciones con la fecha, hora y resultados
Impresión	Via bluetooth a impresora térmica portátil (accesorio opcional)
Ingreso de información	Ingresa el nombre del evaluador, del evaluado, placa de vehículo
Dimensiones	Aproximado 280 mm x 50 mm x 41 mm
Periodo de calibración	Cada 12 meses (tienes recordatorio de calibración)
Peso	280 gramos con baterías incluidas
Incluye	Certificado de calibración de fábrica, cargador y cables USB, 5 boquillas, 5 conos de muestreo y estuche portable
Certificaciones	CE, FDA y cumple con Norma Metrológica Peruana NMP 012-2010
Acreditaciones	Acreditado por INACAL con certificado de verificación aprobatorio para marca y modelo
Garantía	12 meses contra defectos de fabricación
Acseorio opcional	Impresora térmica portátil bluetooth

CERTIFICACIONES

